

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 180
10 – 561 Olsztyn

***Do wiadomości
uczestników postępowania***

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 130 tys. na wybór wykonawcy zadania: Dostawa lampy zabiegowej dla oddziału chirurgii plastycznej - powtórka. Postępowanie DZPZ/333/162/2023.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 130 tys. na realizację zadania: Dostawa lampy zabiegowej dla oddziału chirurgii plastycznej - powtórka do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z 84 diodami LED w kopule?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści lampę operacyjną z 84 diodami LED w kopule.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową sufitową wyposażoną w 72 diody LED? Jest to parametr niewiele różniący się od wymaganego zapewniający bardzo dobre parametry oświetleniowe w obszarze pola operacyjnego przy niskim zużyciu energii.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w 72 diody LED.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, której średnica czaszy wynosi 63 cm. Jest to parametr niewiele różniący się od wymaganego, a zarazem pozwalający zachować bardzo dobre warunki w obszarze pola zabiegowego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści lampę, której średnica czaszy wynosi 63 cm.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, w której stopień ochronności równy jest IP20 wystarczający do warunków panujących na bloku operacyjnym.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści lampy, w której stopień ochronności równy jest IP20.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, w której jest możliwość doboru temperatury barwowej 4500 i 5000K. Są to parametry niewiele różniące się od wymaganych, barwa 5000K jest najbardziej zbliżone do światła dziennego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści lampę, w której jest możliwość doboru temperatury barwowej 4500 i 5000K.

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową, w której współczynnik oddawania barwy czerwonej $R9 \geq 90$. Jest to parametr niewiele różniący się od wymaganego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści lampy, w której współczynnik oddawania barwy czerwonej $R9 \geq 90$.

Pytanie 7

Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit - strop na którym będzie dokonany montaż lampy?

Odpowiedź: Sufit wykonany jest z żelbetonu, wysokość pomieszczenia 3300 mm.

Pytanie 8

Czy występuje sufit podwieszany, jeśli tak to na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od stropu?

Odpowiedź: Brak jest sufitu podwieszanego.

Pytanie 9

Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca doprowadził przewody we własnym zakresie, odległość od rozdzielni ok.50m.


Pytanie 10

Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa, jeśli tak to proszę o podanie producenta i modelu?

Odpowiedź: W miejscu montażu nie ma obecnie lampy.

Pytanie 11

Prosimy o podanie następujących informacji:

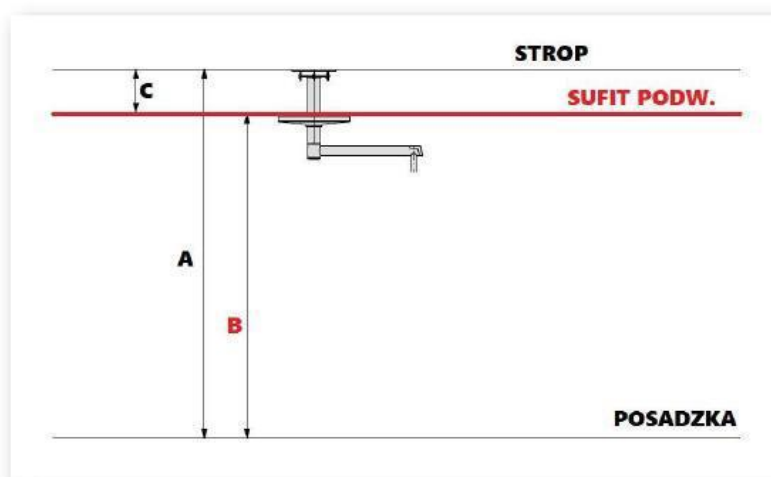

- A. Wysokość do stropu oraz typ stropu [kanałowy / gęsto żebrowy / żelbeton / inny:.....]
B. Wysokość do sufitu podwieszanego oraz typ sufitu podwieszanego [płyta gipsowokartonowa / kasetony GK (50x50 lub 60x60) / kasetony blacha (50x50 lub 60x60) /

inny:]
C. Dystans pomiędzy A i B

Odpowiedź: Informacje do wyżej przedstawionego rysunku zawierają wcześniejsze odpowiedzi.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści lampę z czaszą przystosowaną do nawiewu laminarnego jak na zdjęciu poniżej? Czasza wykonana z tworzywa sztucznego. Czasza współpracująca z nawiewem laminarnym z otworem w jej centralnym punkcie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści lampę z ww. wymienionym nawiewem laminarnym.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści również sterowanie parametrami lampy poprzez panel dotykowy jak na zdjęciu poniżej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści lampę ze sterowaniem poprzez panel dotykowy jak na zdjęciu.



Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulowanym natężeniem oświetlenia w 5 krokach w zakresie 25%-100% oraz możliwość aktywowania światła endoskopowego jednym przyciskiem ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści lampę o w/w parametrach.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją temp. barwowej 3600 / 4200 / 4800 / 5400 K ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści lampę o w/w parametrach.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści lampę z całkowitym poborem mocy max. 100 W ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści lampę o w/w parametrach.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wymagać będzie lampy operacyjnej z funkcją Smart Sensor – funkcja ta zapewnia, że niechciane cienie oddane np. przez głowę, ręce chirurga są automatycznie wyrównywane ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści lampę o w/w parametrach.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści matryce LED osłonięte łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną z tworzywa sztucznego odpornego na dezynfekcję.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści lampę o w/w parametrach.

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wielkości minimalnej i maksymalnej średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym dla czaszy lampy od 180 do 300 mm (w 5 krokach)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści lampę o w/w parametrach.

UWAGA: Wszystkie odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Dyrektor WSS w Olsztynie

Irena Kierzkowska