

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Żołnierska 18

10 – 561 Olsztyn

Pytania i odpowiedzi :

Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 130 tys. zł o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ostrzy chirurgicznych.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia:

PYTANIE DO FORMULARZA CENOWEGO


Czy Zamawiający wymaga, aby ostrza miały wygrawerowaną nazwę producenta i rozmiar bezpośrednio na ostrzu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza możliwość zaofierowania ostrzy o podanych powyżej parametrach.

Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniach a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość wyceny opakowań a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Czy zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne, które na opakowaniu mają graficzne oznaczenie rozmiaru i kształt noża, oraz na każdym jednostkowym opakowaniu wyraźne oznaczenie rozmiaru ?

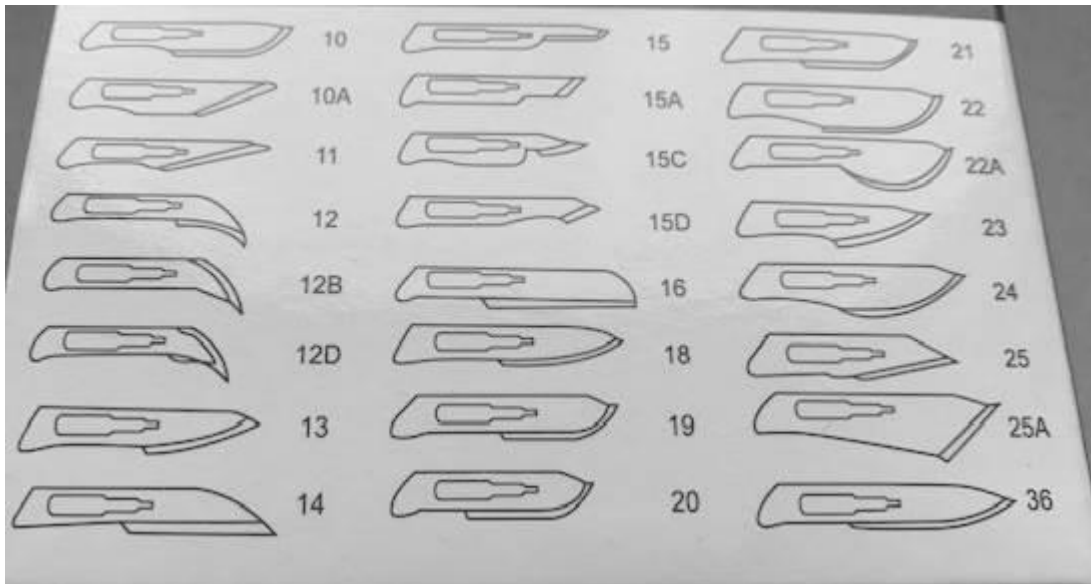

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga zaofierowania ostrzy z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru i kształtu noża zarówno na opakowaniu zbiorczym jak i na opakowaniu jednostkowym każdego nożyka.

Czy zgodzą się Państwo na ostrza chirurgiczne wielorazowe pak po 10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zaoferowanie ostrzy wielorazowego użytku.

PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPISÓW UMOWY § 8 ust. 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie kary umownej do wysokości 1% wartości netto towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego towaru.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

PYTANIE DOTYCZĄCE ZAPISÓW UMOWY § 8

Prosimy o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

DYREKTOR
WSS w Olsztynie
Irena Kierzkowska

(Podpis osoby uprawnionej)