

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

do wiadomości
uczestników postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie do 30 tys euro **na wyposażenie oddziałów szpitalnych w drobny sprzęt medyczny - powtórka.**

Niniejszym Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

Część 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o parametrach;
WÓZEK INWALIDZKI STALOWY WZMOCNIONY - Wózek przeznaczony dla osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się oraz dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi. Napędzany siłą mięśni rąk użytkownika lub poprzez prowadzenie przez osobę towarzyszącą. Może być wykorzystywany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Zalecany osobom o wadze do 225 kg
Cechy produktu:

- stalowa rama malowana proszkowo
- wzmocniony podwójnym krzyżakiem
- regulacja środka ciężkości
- oparcie i siedzisko z odpornego na zanieczyszczenia tworzywa
- podłokietniki w wersji krótkiej z funkcją demontażu
- hamulec postojowy
- stalowe ciągi
- tylne koła pełne gumowe o średnicy 24"
- przednie koła pełne gumowe o średnicy 8"
- uchylne stalowe podnóżki ze skokową regulacją długości
- maksymalne obciążenie: 225 kg

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka o parametrach wyszczególnionych powyżej, ale dla pozycji nr 10. W pozycji nr 11 nie dopuszcza się możliwości zaoferowania wózka o takich parametrach.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o parametrach;

Wózek ze stopów lekkich dla osób bardzo ciężkich do 200 kg z hamulcami bębnowymi dla osoby towarzyszącej.

Wózek wykonany z aluminium. Konstrukcja oparta na podwójnym krzyżaku. W standardzie komfort anatomicznego siedzenia i oparcia .


- Podnóżki jednopłytowe ściągane.
- Tapicerka anatomiczna.
- Podłokietniki wyciągane i odchylane za oparcie

koła tylne wzmocnione -specjalne do przewożenia ciężkich

								
85	60	20	53	57	53	114	~30 kg	200
90	65				54			
95	70				55			
100	75				56			

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka o parametrach podanych powyżej w części nr 11, ale tylko w sytuacji kiedy szerokość siedziska będzie wynosiła co najmniej 70 cm.

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach:

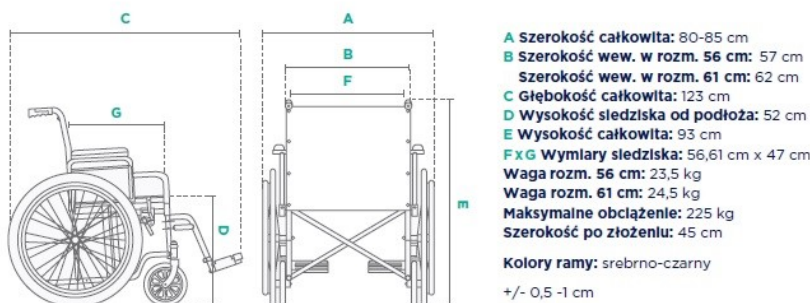

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w części nr 11 nie dopuszcza możliwości zaoferowania wózka o parametrach przedstawionych na powyższym zdjęciu.

Część nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego barierki boczne o wysokości 18 cm ponad leże o parametrach;




- Szerokość: 88 cm, Długość: 211,5 cm
- Wysokość: 57 - 99 cm

- Średnica kół: 12,5 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 250 kg
- Waga: 76 kg
- Regulacja kąta nachylenia leża: 0° - 10°
- Wymiary podglówka: 63x63 cm
- Wymiary leża: 130x63 cm
- Kąt nachylenia podglówka: -25° - 60° (sprężyna gazowa)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka o parametrach wyszczególnionych powyżej.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z dopuszczalnym obciążeniem do 200 kg i parametrach;

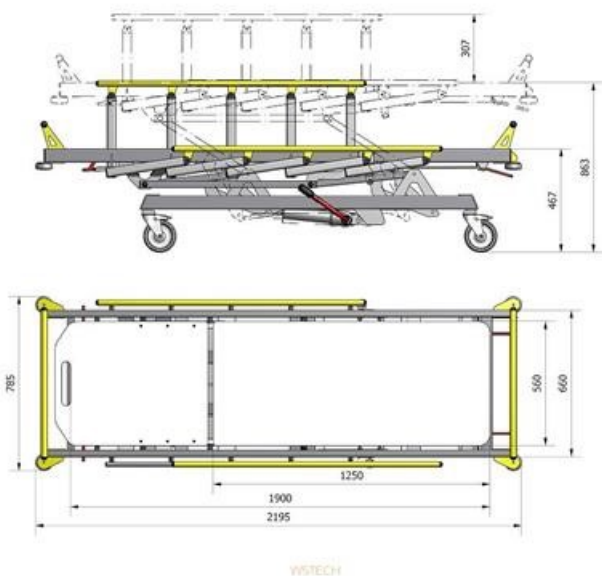

Wózek wykonany jest z profili stalowych malowanych proszkowo. Regulacja wysokości wózka odbywa się hydraulicznie. W standardzie wózek wyposażony jest składane barierki boczne, regulowany podglówek oraz krążki odbojowe. Na blat wózka składa się płyta HPL przezierna dla promieni RTG oraz materac z pianki poliuretanowej obszyty materiałem typu MEDITAP.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania wózka o parametrach wyszczególnionych powyżej.

.....
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Olsztynie