

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn*

*Do wiadomości
uczestników postępowania*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożń jednorazowych - powtórka (*Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie nr 53325-2016 z dnia 13-05-2016r.*)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy *Prawo zamówień publicznych*, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

UWAGA:

Wszystkie dopuszczenia i zmiany wynikające z odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawca winien nanieść na formularz cenowy w kolumnie oferowany przedmiot zamówienia z wyraźną adnotacją: „dopuszczono odpowiedziami na pytania”.

Pakiet nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zestawie do chirurgii biodra serwety nieprzylepnej o wymiarze 75 x 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania zestawu o wyżej wymienionych parametrach i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do chirurgii biodra z serwetą nieprzylepną o wymiarze 75 x 90cm oraz dołączanie do zestawu osobno pakowanej serwety przylepnej o wymiarze 75 x 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania zestawu o wyżej wymienionych parametrach i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do zabiegów na biodrze o składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo Special 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezyjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 60 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych

1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 260 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów?

Wszystkie serwety wykonane są z materiału 2 warstwowego o gramaturze min 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego dodatkowe wzmocnienia. Materiał obłożenia spełnia normę EN 13795.

Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania zestawu o wyżej wymienionych parametrach i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Prosimy o dopuszczenie zestawu do chirurgii biodra, 3 warstwowego bez dodatkowych wzmocnień, natomiast o zwiększonej gramaturze min. 75g/m², w skład którego wchodzi :

1 serweta z wycięciem U-kształtnym 200 x 300 cm

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190cm

1 serweta 75 x 90 cm

1 serweta 150 x 200 cm

1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z organizatorem przewodów w formie rzepu

1 serweta na stół Mayo 80 x 145 cm

2 ręczniki do rąk 40 x 40 cm


1 osłona na kończynę 35 x 120 cm

2 OP Taśma 10 x 50 cm

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania zestawu o wyżej wymienionych parametrach i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 zestawu do chirurgii biodra w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta 100 x 150cm
- 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna)
- 1 osłona na nogę 36 x 120 cm
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta 230 x 260 cm, z wycięciem „U” 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50x100cm, z organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

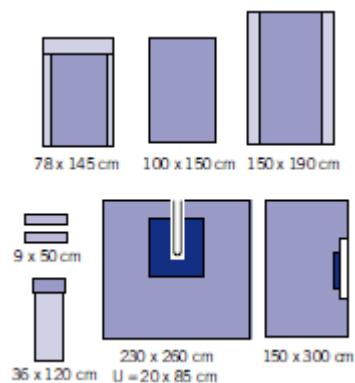

Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μ, w części chłonnej polipropylen


Gramatura w części podstawowej 60g/m²

Gramatura w części chłonnej 80g/m² ŁATA CHŁONNA

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania zestawu o wyżej wymienionych parametrach i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 zestawu do chirurgii biodra w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo
- 4 ręczniki do rąk
- 3 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 przylepna serweta średnia z warstwą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, warstwą chłonną 25 x 60 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna)
- 1 elastyczna osłona na nogę 30 x 120 cm
- 1 elastyczny bandaż 12cmx6m

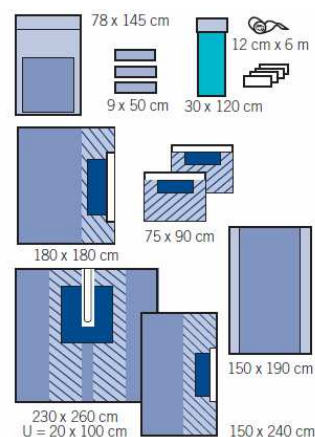

- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm z warstwą chłonną 25 x 60 cm (3-warstwowe na całej powierzchni)
- 1 serweta z wycięciem „U” z warstwą chłonną i organizatorami przewodów, 230x260cm, wycięcie 20 x 100 cm, warstwa chłonna 75 x 140 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna)
- 1 serweta przylepna duża 150x240cm z warstwą chłonną 25 x 60 cm i organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta)

Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 75g/m²

Gramatura w części chłonnej 80g/m² ŁATA CHŁONNA

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania zestawu o wyżej wymienionych parametrach i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do chirurgii biodra zgodnego z SIWZ, jednakże w którym zamiast serwet samoprzylepnej o min. wymiarach 75 x 90cm jest serweta nieprzylepna o wymiarach 75 x 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania zestawu o wyżej wymienionych parametrach i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pakiet 1, pozycja 1, Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x Serweta na stół instrumentariuszki o wym. 150 cm x 190 cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

1 x Serweta na stół Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm

Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.

Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu.

Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m². Serweta składana teleskopowo,

z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwi wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.

Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmocniającej 140 cm x 60 cm.

Chłonność serwety 350%.

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm

Serweta z wycięciem U samoprzlepny o wym. 8,5 x 85 cm, z łata chłonna o wym. 75x50cm i 2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 150x180cm

Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, plynny, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%.

1 x Serweta o wym. 170x180cm

Serweta samoprzylepna z łata chłonna o wym. 80x50cm i 1dnym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny . Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Rękaw o wym. 30 x 60cm

Rękaw 2 - warstwowy. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm

Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m², chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw jałowy, sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC. Opakowanie posiada 2 naklejki typu TAG służące do wklejania w dokumentacji pacjenta. Na każdej naklejce znajdują się następujące informacje: kod produktu, data ważności, nr serii, identyfikacja wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania zestawu o wyżej wymienionych parametrach i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pakiet nr 2

pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę niebieską bez rozcięcia z włókniny SMS 33g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania koszuli o wyżej wymienionych parametrach i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę niebieską bez rozcięcia z włókniny SMS 33g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania koszuli o wyżej wymienionych parametrach i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pakiet nr 3

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do artroskopii barku w składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna (elastyczna) na kończynę, krótka 24 cm x 80 cm


1 foliowa taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 samoprzylepna serweta do artroskopii stawu barkowego 225 cm x 380 cm z samouszczelniającym się otworem w kształcie gruszki 11,5 cm x 12,5 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów posiadającą sztywnik z zaworem do podłączenia drenu z trzema uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep? Zestaw zgodny z normą EN 13 795.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania zestawu o wyżej wymienionych parametrach i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 4 ręczniki do rąk
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
- 1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm
- 1 serweta do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm (torba na płyny trójkątna o wymiarach 105cm każdy bok) i z 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm + filtr i port do odsysania (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

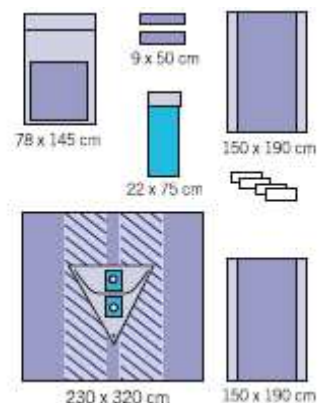

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania zestawu o wyżej wymienionych parametrach i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do artroskopii barku zgodnego z SIWZ, jednakże w którym serweta na stół narzędziowy ma rozmiar 140 x 190 cm natomiast serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem do zbiórki płynów ma rozmiar 225cm x 400cm. Zaoferowany zestaw zawiera w swoim składzie dodatkowo 4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm oraz uchwyt Velcro 2 x 23cm.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o wyżej wymienionych parametrach , przy zachowaniu pozostałych wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu o następującym składzie:

- 1 x serweta do angiografii 240 x 340 cm, otwory udowe przylepne \varnothing 8 (otoczone folią operacyjną o szerokości 4 cm) i otwory promieniowe przylepne 7 x 12 cm, przezroczysta osłona na pulpity obustronnie 67 x 220 cm. Pad chłonny 110 x 150 cm i 70 x 90 cm. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) z wzmocnieniem w części krytycznej. Gramatura laminatu 55 g/m², zaś w obszarach wzmocnionych gram. 110g/m². Odporność na przenikanie cieczy >200 cm (H₂O),
- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu) gramatura zgodna z SIWZ, odporność na przenikanie części w części wzmocnionej >200 cm (H₂O),
- 1 x osłona na sprzęt medyczny 85 x 150 cm, PE, prostokątna
- 1 x osłona na sprzęt medyczny 90 x 45 cm, PE, okrągła
- 2 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

Fartuch chirurgiczny pakowany oddzielnie, niezależnie od zestawu.

Fartuch wykonany z włókniny typu SMMMS o gramaturze 40g/m², w części wzmocnionej dodatkowo 38g/m². Odporność na penetrację płynów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania zestawu o wyżej wymienionych parametrach i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pakiet nr 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego o następujących parametrach

Serwety wykonane z chłonnego trzywarstwowego laminatu włókniny polipropylenowej, folii polietylenowej oraz wiskozy o minimalnej gramaturze 77g/m². Skład :

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE, wzmocniona włókniną polipropylenową o min. gram. 40 g/m².
- 1 serweta główna o min. wym. 200/250x345cm, z przyklepnym oknem (18x28x32cm) otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm , 2. zaworami i kształtownikiem,
- 1 owinięcie dla noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m² o min. wym. 90x100cm;
- taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 150x190cm, wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o wyżej wymienionych parametrach , przy zachowaniu pozostałych wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w poz. 1 serwety do zabiegu cięcia cesarskiego, spełniające pozostałe wymogi SIWZ, gdzie:

| | | |
|---|-------------|---|
| 1. serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywne, połączenie ssaka i organizatory przewodów | 175/250x300 | 1 |
| 2. serweta - owinięcie noworodka | 90x120 | 1 |
| 3. taśma samoprzylepna | 9x49 | 1 |
| 4. ręczniki chłonne | 18x25 | 4 |
| 5. osłona na stolik Mayo | 79x145 | 1 |
| 6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania zestawu o wyżej wymienionych parametrach i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek w zakresie Pakietu nr 6 do ilości 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego w składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji na plecach, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicach jamy brzusznej, z oknem 14 cm x 20 cm otoczonym folią chirurgiczną ze zintegrowaną torbą na płyny z lejkiem odprowadzającym płyny z osłoną podpórek kończyn górnych? Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.

Gramatura laminatu 57,5 g/m².


Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Cały zestaw zawinięty w serwetę na stół instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem hypoalergicznym i repositionowalnym (umożliwiającym swobodne odklejenie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania zestawu o wyżej wymienionych parametrach i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 6 niżej opisanego zestawu?

- 4 ręczniki do rąk
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo
- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm

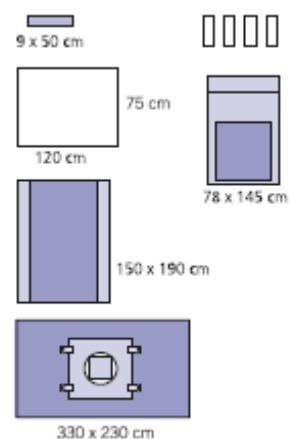

- 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z torebką na płyny, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni)
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µm, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 60g/m²

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H₂O

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o wyżej wymienionych parametrach , przy zachowaniu pozostałych wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150 x 200 cm (opakowanie zestawu)
- 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny oraz oknem 29 x 19 cm wypełnionym folią chirurgiczną 250x315 cm (ułożenie płasko na stole)
- 1 chłonna serweta dla noworodka 87 x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm

Oferowany zestaw wykonany jest z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55g/m² i wytrzymałości na przenikanie cieczy >200 H₂O?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu o wyżej wymienionych parametrach , przy zachowaniu pozostałych wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego w składzie:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z dodatkowymi przyklepcami do fiksacji serwety, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów

otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰, z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół

otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie.

Serwety wykonane z włókniny o gramaturze minimum 66g/m² w obszarze podstawowym, 144g/m² w obszarze krytycznym, odporność na przenikanie płynów odpowiednio minimum 200cm H₂O oraz 350cm H₂O.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania zestawu o wyżej wymienionych parametrach i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, iż serweta do cięcia cesarskiego będzie w kształcie litery T, dzięki czemu poprzez wytworzenie obszernego ekranu anestetycznego istnieje możliwość zabezpieczenia ramion stołu operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z rutynowym odkładaniem narzędzi na nogi pacjentki Zamawiający oczekuje, aby serweta do cięcia cesarskiego posiadała wzmocnienie na części serwety okrywającej kończyny pacjentki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego w składzie:

-1 x serweta na stół narzędziowy min. 152x190cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stół Mayo min. 75x141 cm

-1 x kocyk dla noworodka 76x86 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307cmz obłożeniem ramion stołu, z otworem brzuszным 33x38cm wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze

zintegrowaną torbą na płyny 360⁰ z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym poniżej otworu,

3 zintegrowane organizatory przewodów.

Serwety okrywające wykonane z repelentnego materiału SMMMS o gramaturze 43g/m², z wzmocnieniem o gramaturze łącznej sięgającej nawet 116g/m², odporność na przenikanie płynów minimum 200 cm H₂O w obszarze podstawowym oraz minimum 31 cm H₂O w obszarze podstawowym, natomiast w pozostałym zakresie serwety są zgodne albo nawet przewyższają parametry określone w zapisach SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania zestawu o wyżej wymienionych parametrach i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści osłonę na mikroskop o wymiarze 115x260cm , średnica optyki 65mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania osłony o wyżej wymienionych parametrach i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pakiet nr 12

Poz. nr 3 i 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania masek chirurgicznych spełniających wymagania SIWZ, jednakże o efektywności filtracji bakteryjnej $\geq 98\%$?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania masek o wyżej wymienionych parametrach i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poz. nr 5 – zwracamy się z prośbą o włączenie ww. pozycji z pakietu nr 12. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Państwu umożliwi wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw masek chirurgicznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgodę na powyższe i podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pakiet nr 13

pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę o średnicy 820cm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości zaoferowania osłony o wyżej wymienionych parametrach i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytania ogólne, oraz do projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaliczenie do niniejszego postępowania próbek złożonych w ramach postępowania znak DZPZ/333/5UE PN/2016?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgodę na powyższe i podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 8, ust. 1- wnosimy o zmianę umowy przez obniżenie wysokości kar umownych, które w aktualnym brzmieniu stanowią kary rażąco wygórowane.

- § 8 ust. 1 do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej części umowy,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści dołączanie do oferty próbek niesterylnych w zakresie Pakietu 1, 4, 5, 7, 13 w ilości 2 szt. do każdej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, tj. na dołączanie do oferty próbek niesterylnych w zakresie pakietów 1, 4, 5, 7, 13 w ilości 2 szt. do każdej pozycji.

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,5% w § 8 pkt 1. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 9 ust. 4 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.....

podpis osoby upoważnionej

