

Olsztyn, dnia 29-03-2018

*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. Żołnierska 18  
10 – 561 Olsztyn*

*do wiadomości uczestników postępowania*

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę obłożeń operacyjnych** (*Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Ogłoszenie nr 2018/S 044-095523 z dnia 03-03-2018*).

**Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

### **Część nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety o wyższej gramaturze, 3 warstwowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że pytanie zostało nieprecyzyjnie zadane, Wykonawca nie określił wysokości gramatury oferowanej serwety, w związku z czym Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.

### **Część nr 2 poz. 2**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszczając tolerancję w tej pozycji dopuszcza otwór 6x8cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że tolerancja dopuszczona jest w rozmiarze serwety, a nie otworu. Otwór winien być o średnicy 6-7 cm, a nie o wymiarze 6x8 cm. Zamawiający nie dopuszcza otworu w serwecie 6x8 cm.

### **Część nr 2 poz. 3**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety o wyższej gramaturze, 3 warstwowej, 50x60cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że pytanie zostało nieprecyzyjnie zadane, Wykonawca nie określił wysokości gramatury oferowanej serwety, w związku z czym Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.

**Część nr 2 poz. 4**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety 150x180cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 2 poz. 5**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety 78x145cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 4**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zgodnie z ustawą PZP dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, m.in. produktu w składzie:

- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 2 ręczniki do rąk 30,5x34cm
- 2 przyklejane serwety 75 x 90 cm
- 1 przyklejana serweta średnia 180 x 180 cm
- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Serwety wykonane z materiału 2-warstwowego / włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa / o gramaturze 60gr/m<sup>2</sup>, Wytrzymałość na przenikanie cieczy 165 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie 168 kPa. Taśma samoprzylepna na serwetach o szer. 5 cm. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny.

- zgodny z normą EN 13795 1-3. Cztery etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, lot, datę ważności oraz dane producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 10**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zgodnie z ustawą PZP dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, m.in. produktu w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 4 ręczniki do rąk 30,5x34cm

**DZPZ/333/8 UEPN/2018**

• 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

• 1 elastyczna pończocha 22 x 75 cm

• 1 serweta (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta) do artroskopii z torebką na płyny 230 x 320 cm (torba na płyny trójkątna o wymiarach 105x90cm) i z 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm + filtr i port do odsysania

• 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 14**

Czy Zamawiający dopuści jeden z poniższych zestawów do CC:

#### **ZESTAW 1:**

- 4 ręczniki do rąk
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z torebką na płyny 72x72cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Materiał serwet głównych 2 warstwowy o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w części podstawowej.

Odporność na rozerwanie 168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H<sub>2</sub>O.

LUB

#### **ZESTAW 2:**

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 4 ręczniki do rąk
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
- 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z torbą na płyny 102x112cm, wzmocniona gąbką i sztywnikiem aluminiowym wokół otworu owalnego, folia operacyjna 36 x 36 cm, 4 organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

DZPZ/333/8 UEPN/2018

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Materiał serwet głównych 2 warstwowy o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w części podstawowej.

Odporność na rozerwanie 168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H<sub>2</sub>O.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### Część nr 19

Czy Zamawiający dopuszcza również osłonę 8cm x 120cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pytanie zostało nieprecyzyjnie zadane, Wykonawca nie określił której pozycji w części dotyczy pytanie, w związku z czym Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.**

#### Część nr 34


Czy Zamawiający dopuszcza również fartuch wizytacyjny z włókniny SMS 13g/m<sup>2</sup>, mankiet w postaci elastycznej gumki, długość fartucha 120cm – rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### Część nr 39

Czy Zamawiający dopuszcza również zestaw do operacji TUR w składzie:

- 1 przylepiec Velcro 2,5 x 30 cm
- 1 ręcznik do rąk
- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm
- 1 serweta TUR 175/270 x 170 cm zintegrowana, z osłoną na palec o średnicy 3cm, otworem o średnicy 6cm i przylepnym otworem o średnicy 8cm, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm



Materiał serwet głównych 2 warstwowy o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w części podstawowej.

Odporność na rozerwanie 168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H<sub>2</sub>O.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**DZPZ/333/8 UEPN/2018**  
**dotyczy ZAPISÓW SIWZ**

Z uwagi na zapis w SIWZ „VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów...” dotyczący dostarczenia wraz z ofertą próbek do w/w postępowania w ilości 2szt do każdej pozycji asortymentowej, zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od w/w wymogu. Kryterium oceny ofert stanowi bowiem 100% cena. Zgodnie z nowelizacją ustawy Zamawiający wzywa do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań stawianych w SIWZ ofertę najkorzystniejszą <po otwarciu ofert>. Procedura ta dotyczy również próbek. Stawianie wymagania dostarczenia próbek wraz z ofertą bez oceny ich jakości jako pozacenowego kryterium nie powinno stanowić wymagania bezwzględnego wg nowelizacji ustawy PZP.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek, pomimo tego, że nie będą one poddane ocenie jakościowej, a jedynie na potwierdzenie ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Zgodność zaoferowanego przedmiotu z wymaganiami Zamawiającego niezbędna jest do sporządzenia rankingu najwyżej ocenionych ofert. Zgodnie z art. 24aa Ustawy pzp Zamawiający najpierw dokona oceny przedmiotowej wszystkich ofert, potem wyłoni ofertę najkorzystniejszą na podstawie określonych kryteriów oceny ofert, później dokona oceny podmiotowej Wykonawcy. Mając na względzie powyższe – wymóg dostarczenia próbek, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostaje podtrzymany.**

**Część nr 4, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą w rozmiarze:

- 2 x 75cmx90cm (zamiast 75cm x 100cm),
- 150 cm x180cm (zamiast 150-160x200-210cm),
- 150 x 230 cm (zamiast 150x240cm),

pozostałe parametry jak w SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.**

**Część nr 4, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z 4 ręczniczkami do rąk?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.**

**Część nr 4, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z parametrami technicznymi spełniającymi wymagania wysokie wg normy EN 13795?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oczekuje, aby przedmiot zamówienia spełniał normy określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 5, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze M (114x142cm) lub w rozmiarze L (117x148cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza rozmiar koszuli (114x142cm) przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.**

**Część nr 5, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 33g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 6, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 6, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SSMMS?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 6, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem z elastycznej dzianiny poliestrowej?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 7, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o parametrach:

Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony - jednorazowego użytku do zabiegów wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny SMS, sterylny, w strefie krytycznej od wewnątrz wzmocniony wstawkami z nieprzemakalnego laminatu (z przodu do ok. 20cm nad dolną krawędzią fartucha), rękawy zakończone poliestrowym bezszwowym mankietem. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, przy szyi zapięcie na rzep. Włóknina o gramaturze 73g/m<sup>2</sup> w obszarze krytycznym, poza obszarem krytycznym min 35g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym 66cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie dla obszaru krytycznego na sucho i mokro min. 210/200 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro 90N. Opakowanie typu papier folia, min. dwie etykiety w języku polskim zawierająca nr katalogowy, serię, datę ważności, oznaczenie producenta. Długość fartucha od najwyższego punktu ramienia: M-124cm, L-128cm, XL-138cm, XXL- 157cm. Rozmiary M,L,XL,XXL. Zgodny z normą PN EN 13795.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 10, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną w rozmiarze 263x406cm, osłoną na kończyne 22x75cm oraz 4 ręcznikami do rąk, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 12, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1x serweta do stymulatorów o wymiarach 180x305cm wykonana w całości z min. 2 warstwowego, nieprzemakalnego laminatu, wyposażona w dwa otwory eliptyczne o wymiarach 12x15cm wypełnione folią chirurgiczną. W strefie krytycznej wokół otworów dodatkowe wysokochłonne wzmocnienie 80g/m<sup>2</sup> o wymiarach 50x85cm . Łączna gramatura serwety w strefie krytycznej min. 136 g/m<sup>2</sup>.

1x osłona na sprzęt medyczny wyposażona w elastyczną gumkę , w kształcie kuli o średnicy 80cm, wykonana z transparentnej folii PE o grubości 50um

DZPZ/333/8 UEPN/2018

1x fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 w rozmiarze XL

2x ściereczki do rąk o wymiarach 30x30cm

1x serweta na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150x190cm

Parametry techniczne zestawu spełniają wymagania wg normy EN 13795?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 14, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, odporność na przenikanie płynów 41,7 cm H2O
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2
1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m2
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 20, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 14x25cm z warstwa lepna w rozmiarze 14x21cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**



**Część nr 20, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 28x30cm z warstwa lepną w rozmiarze 22x30cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 20, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45x55cm z warstwa lepną w rozmiarze 45x49cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zaoferowania folii w rozmiarze określonym powyższej, przy zachowaniu pozostałych wymogów o kreślonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 20, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56x84cm z warstwa lepną w rozmiarze 56x78cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 20, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 55x55cm z warstwa lepną w rozmiarze 55x51cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 20, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56x84cm z warstwa lepną w rozmiarze 56x78cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 20, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 40x42cm z warstwa lepną w rozmiarze 40x36cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 21, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x52cm z warstwa lepną w rozmiarze 60x46cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 21, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 42x42cm z warstwa lepną w rozmiarze 42x36cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 22, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o parametrach:

1 x serweta porodowa o wymiarach 114cm x 150cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 60 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wzmocnienie o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>. Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 50cm, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 26, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści podkład z 3 powłok: włóknina, wkład chłonny, laminat nieprzemakalny (spodnia strona) w rozmiarze całkowitym 100x225cm i chłonności 3850ml?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

**Część nr 28, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 65x85cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 30, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści czepek z włókniny o gramaturze 18g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

**Część nr 30, poz.2**

Czy Zamawiający dopuści czepek z włókniny spunlace 45g/m<sup>2</sup> – otok i włókniny polipropylenowej 25g/m<sup>2</sup>-denko?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

**Część nr 31, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwiu o gramaturze 30g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 32, poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maskę zgodną z normą EN 14683 typ IIR i ciśnieniu różnicowym 30,88 Pa/cm<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

**Część nr 32, poz.3-4**

Czy Zamawiający dopuści ciśnienie różnicowe poniżej 29,4 Pa/cm<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 34, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o dł. 120cm i szerokości ok. 140cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

**Część nr 35, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści komplet operacyjny o wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 39, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną z otworem w części kroczonej o średnicy 6cm, pozostałe parametry jak w SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 39, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o odporności na przenikanie cieczy 188cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii biodra wykonanego trójwarstwowego laminatu z dodatkową warstwą wzmacniającą w strefie krytycznej. Wymogi odnośnie gramatury serwet zgodne z SIWZ.

W skład zestawu wchodzi :

1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów ..... 300x175 1
2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej ..... 200x260 1
3. serweta chirurgiczna ..... 75x90 1
4. serweta na stolik ..... 150x190 1
5. osłona na kończynę ..... 32x120 1
6. taśmy samoprzylepne ..... 9x49 2
7. ręczniki chłonne ..... 18x25 4
8. wzmocniona osłona na stolik Mayo ..... 79x145 1
9. wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu) ..... 150x190 1

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

**Część nr 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu podstawowego wykonanego dwuwarstwowego laminatu z dodatkową warstwą wzmacniającą w strefie krytycznej.

Wytrzymałość na przenikanie cieczy 203 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie 29 N.

W skład zestawu wchodzi :

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów .....	240x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej .....	90x75	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów .....	175x175	1
4. taśma samoprzylepna .....	9x49	1
5. ręczniki chłonne .....	18x25	4
6. osłona na stolik MAYO .....	79x145	1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) .....	150x190	1

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 6**

**Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny-do procedur standardowych**, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> odporność na nieprzemakalność min. 58 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie min. 75 N; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795. Szwy wykonane technika ultradźwiękowa w strefach krytycznych fartucha. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 7**

**Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony - do zabiegów wysokiego ryzyka**, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>; wyposażony w

DZPZ/333/8 UEPN/2018

nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m<sup>2</sup>, rękawy 40 g/m<sup>2</sup> (łącznie 75g/m<sup>2</sup> w obszarze krytycznym) rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk. Odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia 194 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro min. 87N Zgodny z **normą PN EN 13795**. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia 2,1 Log 10 (liczby cząstek). Szwy wykonane technika ultradźwiękowa w strefach krytycznych fartucha. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### Część nr 14

Czy zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z czterowarstwowej, nieprzemakalnej, barierowej włókniny, pozostałe parametry zgodne z siwz, skład zestawu:

1. serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywne, podłączenie ssaka i organizatory przewodów .....175/250x300 1
2. serweta - owinięcie noworodka ..... 90x120 1
3. taśma samoprzylepna ..... 9x49 1
4. ręczniki chłonne ..... 18x25 4
5. osłona na stolik Mayo ..... 79x145 1
6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) ..... 150x190 1

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### Część nr 35

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku, w komplecie bluza z krótkim rękawem i spodnie proste, wiązane na troki, bluza z kieszeniami, dekolt możliwie niewielki ale umożliwiające swobodne włożenie bluzy przez głowę; ubranie wykonane z włókniny

DZPZ/333/8 UEPN/2018

polipropylenowej SMS typu Spunbonded 35 gr/m<sup>2</sup>; nić zszywająca wykonana z nylonu, kolor niebieski; nieprześwitujące, rozmiary co najmniej: S, M, L, XL, XXL?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 2, pozycja 2**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 2 Pozycji 2

Sterylniej serwety do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych o wymiarach 50x70 cm z otworem 6x8 cm otoczonym taśmą lepną (*zamiast o wymiarach 50x60 cm +/-5% z otworem 6-7 cm otoczonym taśmą lepną*). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 7, pozycja nr 2**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 7 Pozycji 2

Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony - jednorazowego użytku do zabiegów wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny SMS, sterylny, w strefie krytycznej od zewnątrz wzmocniony wstawkami z nieprzemakalnego laminatu (z przodu do dolnej krawędzi fartucha), rękawy zakończone mankietem. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, przy szyi zapięcie na rzep. Włóknina o gramaturze min. 73g/m<sup>2</sup> w obszarze krytycznym, poza obszarem krytycznym min. 35g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym min. 144 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie dla obszaru krytycznego na sucho i mokro min. 60kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro min. 114N. Opakowanie typu papier folia, min. dwie etykiety w języku polskim zawierająca nr katalogowy, serię, datę ważności, oznaczenie producenta, kod kreskowy. Długość fartucha od najwyższego punktu ramienia:

rozmiar L – 130 cm, XL – 140 cm, XXL – 160 cm (*zamiast M-115cm, L-125cm, XL-140cm, XXL-155cm*). Rozmiary L, XL, XXL. Zgodny z normą PN EN 13795.?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pytanie zostało nieprecyzyjnie zadane, ponieważ w części nr 7 nie ma pozycji nr 2.**

#### **Część nr 9, pozycja nr 1**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 9 Pozycji 1

DZPZ/333/8 UEPN/2018

Serweta do artroskopii: sterylna wykonana z chłonnego nieprzemakalnego laminatu; gramatura min 57g/m<sup>2</sup>, z elastycznym mankietem neoprenowym wokół otworu 6x8 cm, serweta posiadająca zbiornik na płyny z zaworem do drenu, rozmiar 200x320 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

#### **Część nr 9, pozycja nr 3**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 9 Pozycji 3

Sterylna serweta okulistyczna 150x150 cm, wykonana z włókniny oddychającej, paroprzepuszczalnej trójwarstwowej typu SMS/SMMS o gramaturze min. 45 g/m<sup>2</sup>, z otworem 8x10 cm wypełnionym folią chirurgiczną, serweta jest zintegrowana z jednym zbiornikiem do przechwytywania płynów, z usztywnionym brzegiem do formowania. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

#### **Część nr 14, pozycja nr 1**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 14 Pozycji 1

Zestaw do cięcia cesarskiego z torbą na płyny o następującym składzie zestawu:

- 1 x serweta do cięcia cesarskiego o wymiarach 200x300 cm, wykonana wielowarstwowej włókniny typu SMS/SMMS paroprzepuszczalna, oddychająca o gramaturze min. 45 g/m<sup>2</sup>, w części centralnej serwety znajduje się otwór o wymiarach 25x30 cm, wypełniony folią chirurgiczną, otoczony zbiornikiem 360 stopni do przechwytywania płynów z usztywnionym brzegiem, posiadający zawór do odpływu płynów,
- 1 x osłona na stół Mayo ze wzmocnieniem 80x140 cm,
- 1 x serweta do owinięcia noworodka 70x80 cm,
- 1 x taśma lepna 10x50 cm,
- 4 x ręcznik do rąk
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki 150x190 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61g/m<sup>2</sup>, nieprzemakalności min. 250 cm H<sub>2</sub>O.?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 19, pozycja nr 1**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 19 Pozycji 1



DZPZ/333/8 UEPN/2018

Sterylny pokrowiec na przewody wykonany z mocnej, przezroczystej folii, z taśmami do mocowania na końcówkach, rozm. 14x250 cm, zgodny z normą EN 13795 1-3.?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

#### **Część nr 22, pozycja nr 1**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 22 Pozycji 1

Jałowa serweta pod pośladki ze zbiornikiem na płyny, tj. fartuch z zakładką osłaniający łóżko ze zintegrowanym zbiornikiem do odprowadzania płynów rozmiar 110x100 cm.?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 35, pozycja nr 1**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 35 Pozycji 1

Komplet operacyjny bluza + spodnie włóknina typu SMS/SMMS nieprzezroczysta, włóknina niepyląca o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>. Bluza z min. 1 kieszenią zgodna z normą PN-EN 13795 Spodnie ściągane w pasie trokiem, nogawki bez ściągaczy. Rozmiary M, L, XL, XXL.?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego aby wyraził zgodę, aby na opakowaniu zewnętrznym zestawu sterylnego znajdowały się min. 2 etykiety samoprzylepne umożliwiające wklejenie do protokołu medycznego z identyfikacją danego wyrobu zawierającą: nazwę producenta, nr katalogowy, nr serii, datę ważności, kod kreskowy.?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pytanie zostało nieprecyzyjnie zadane, ponieważ nie wynika z niego, o który zestaw sterylny chodzi, której części i pozycji dotyczy? W związku z powyższym, Zamawiający nie jest w stanie udzielić na nie odpowiedzi.**

#### **Część nr 2**

**Poz. nr 2** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwet zgodnej z SIWZ, jednakże wykonanej z laminatu o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

**Część nr 3**

**Poz. nr 1** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do chirurgii biodra o następującym składzie:


- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 1 x serweta 245 x 280 cm, otwór typu "U" przylepny 10 x 95 cm (pad chłonny 150 x 160cm)
- 1 x serweta przylepna 300 x 170 cm
- 1 x serweta nieprzylepna 200 x 150 cm
- 1 x stokineta 35 x 120 cm
- 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

Zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, ze wzmocnieniem w części krytycznej serwet, o gramaturze 110 g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 4**

**Poz. nr 1** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu podstawowego, następującym składzie:

<b>Zestaw uniwersalny I wzmocniony</b>	
<b>Skład zestawu:</b>	
	1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190
	1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145
	1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240
	1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175
	2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90
	1 taśma samoprzylepna 10 x 50
	4 ręczniki celulozowe 30 x 33

Zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup>, ze wzmocnieniem w części krytycznej serwet, o gramaturze 110 g/m<sup>2</sup>. Wytrzymałość na przenikanie cieczy >200 H<sub>2</sub>O.

Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### Część nr 6

**Poz. nr 1** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania fartucha wykonanego z włókniny SMMMS o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, z poliestrowymi mankietami. Wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 186 kPa, na mokro min. 174 kPa. Fartuch pakowany z dwoma ręcznikami. Pozostałe parametry fartucha bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

#### Część nr 7

Poz. 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania fartucha chirurgicznego wzmocnionego zgodnego z SIWZ, jednakże wykonanego z włókniny SMMMS, ze wzmocnieniem z przodu, kończącym się ok. 20 cm nad dolną krawędzią fartucha. Odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym wynosi 165 H<sub>2</sub>O.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

#### Część nr 10

Poz. 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania Zestawu do artroskopii barku wykonanego z laminatu o gramaturze 55g/m<sup>2</sup>, o następującym składzie:



Zestaw do artroskopii barku	
Skład zestawu:	
1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145
1 serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem na płyn (otwór 7 x 10 cm)	225 x 400
1 samoprzylepna serweta operacyjna	75 x 90
1 osłona na kończynę	25 x 80
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
1 uchwyt Velcro	2 x 23
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

**Część nr 29**

**Poz. nr 1** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu jednorazowego do cewnikowania zawierającego w swoim składzie dodatkowo 1 x igła 1,2 x 40mm, 18G x 1 ½, różowa (zapakowana)?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.

**Część nr 30**

**Poz. nr 1** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania czepek chirurgicznego spełniającego wymagania SIWZ, jednakże o gramaturze włókniny 14g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Poz. nr 2** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania czepek chirurgicznego spełniającego wymagania SIWZ, jednakże o gramaturze włókniny 25g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.

**Część nr 32**

**Poz. nr 3 i 4** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania masek chirurgicznych spełniających wymagania SIWZ, jednakże o gramaturze 54 g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.


**Część nr 34**

**Poz. nr 1** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania fartucha jednorazowego spełniającego wymagania SIWZ, jednakże z rękawami ściągniętymi nieuciskającą gumką bez lateksu?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Część nr 39**

**Poz. nr 1** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania Zestawu do operacji urologicznych, następującym składzie:

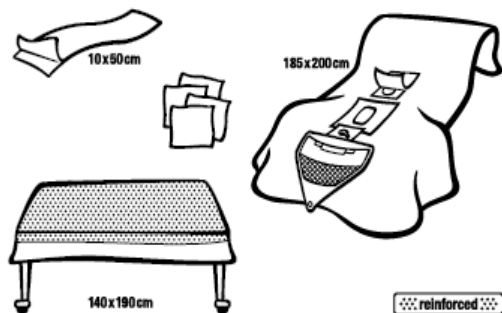

### Zestaw do operacji urologicznych I

#### Skład zestawu:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem) 185 x 200 cm, okno suprapubic (7 x 10 cm) i na krocie (7 cm). Wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania per rectum	185 x 200
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Zestaw wykonany z laminatu o gramaturze zgodnej z SIWZ i odporności na przenikanie płynów min. 200cm H<sub>2</sub>O.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### ZAPISY SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby próbki były dostarczone na wezwanie, tylko przez Wykonawców, którzy zaoferują najbardziej korzystne oferty cenowe do poszczególnych pakietów?

W kryteriach oceny ofert nie ma kryterium dot. jakości, w związku z tym dołączanie próbek do oferty na dzień składania ofert wiąże się z dodatkowymi kosztami ze strony Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga dostarczenia próbek, pomimo tego, że nie będą one poddane ocenie jakościowej, a jedynie na potwierdzenie ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Zgodność zaoferowanego przedmiotu z wymaganiami Zamawiającego niezbędna jest do sporządzenia rankingu najwyżej ocenionych ofert. Zgodnie z art. 24aa Ustawy pzp Zamawiający najpierw dokona oceny przedmiotowej wszystkich ofert, potem wyłoni ofertę najkorzystniejszą na podstawie określonych kryteriów oceny ofert, później dokona oceny podmiotowej Wykonawcy. Mając na względzie powyższe – wymóg dostarczenia próbek, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostaje podtrzymany.**

### Część 17

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony w rozmiarze 122 x 305cm.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

**Część 18**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga złożenia oświadczenia że zaoferowane osłony są kompatybilne z mikroskopem Leica 720 i ich prawidłowe użycie nie spowoduje uszkodzenia mikroskopu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania osłony zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia. Osłona ma być dedykowana do mikroskopu Leica 720.**

**Część 19**

Pozycja 1.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na przewody w rozmiarze 13cm x 235cm.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 19**

Pozycja 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony na przewody w rozmiarze 8cm x 200cm.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 19**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie wymogu spełnienia normy EN13795, gdyż nie dotyczy ona osłon foliowych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał stosownej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 26**

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o chłonności min. 3600ml.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie czy wymaga aby zaoferowane chłonność zaoferowanych podkładów była potwierdzona badaniami z akredytowanego laboratorium?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga aby chłonność zaoferowanych podkładów była potwierdzona badaniami z akredytowanego laboratorium.**

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie czy wymaga aby zaoferowane podkłady posiadały oznaczenie produktu w części chłonnej, co umożliwi identyfikację podkładu po wyjęciu z opakowania?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wymaga powyższego.**

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie:

Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny w rozmiarze 100cm (+/-4cm) x 229cm (+/-5cm). Powierzchnia chłonna pikowana w rozmiarze 50cm (+/-2cm) x 205cm (+/-5cm). Chłonność min. 4L, potwierdzona przez producenta podkładu. W zestawie z dodatkową serwetą do przykrycia lub transportu pacjenta w rozmiarze 101cm (+/-2cm) x 152cm (+/-4cm) i udźwigu min. 200kg.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

**Część 28**

Pozycja 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony w w rozmiarze 50cm po maksymalnym rozciągnięciu gumki.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pozycja 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej prostokątnej osłony w rozmiarze 85cm po maksymalnym rozciągnięciu gumki.

Jakość i łatwość nakładania będzie możliwa do sprawdzenia na podstawie załączonych próbek.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytania dotyczące treści umowy:**

Zważywszy na treść § 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towarów (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w związku ze specyfiką prowadzonej działalności nie jest w stanie przewidzieć minimalnej ilości towarów, którą na pewno zamówi. Zamawiający oczekuje złożenia oferty cenowej na ilości określone w formularzu cenowym będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ.**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Strony mogą wyjątkowo zmienić ceny jednostkowe netto w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?*

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.**



Czy Zamawiający zgadza się aby do wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie podtrzymuje zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.**

#### **Cześć nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji zarękawka o długości 45 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Cześć nr 4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji obłożenia o następujących parametrach:

serweta z przylepcem	1	L2 – laminat dwuwarstwowy o gram. 56g/m2	240x150
serweta z przylepcem	1	L2 – laminat dwuwarstwowy o gram. 56g/m2	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	L2 – laminat dwuwarstwowy o gram. 56g/m2	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. Kom.	40x20

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

**Cześć nr 6**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji fartucha o następujących parametrach:

- mankiet poliestrowy
- gramatura 35g/m<sup>2</sup>
- wytrzymałość na wypychanie min. 43 kPa
- brak spełniania wymogów klasy I palności

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Cześć nr 30, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w wyżej wymienionej pozycji czepka wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 2 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety jałowej dwuwarstwowej przylepnej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 2 poz. 4:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety jałowej dwuwarstwowej o rozm. 150 cm x 190 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

**Część 6 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów z włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, z mankietami wykonanymi z dzianiny poliestrowej, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 188 kPa/170kPa, rozmiary: M-L, XL, XXL? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Część 7 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów wzmocnionych z włókniny typu SMMS o odporności na przenikanie cieczy w części przedniej 123 cmH<sub>2</sub>O, w rękawach 194 cmH<sub>2</sub>O, wytrzymałości na rozciąganie sucho/mokro w obszarze krytycznym min. 70 N oraz rozmiarach S/M 120cm; L 130cm; XL 150 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Część 8 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kieszeni na narzędzia chirurgiczna jednokomorowej o wymiarach 38 x 40 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.

**Część 11 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do zabiegów kardiochirurgicznych o gramaturze laminatu podstawowego 57,5 g/m<sup>2</sup> oraz w obszarze wzmocnionym 109,5 g/m<sup>2</sup>, o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

2 serwety na stół Mayo 80 cm x 145 cm

2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9 cm x 50 cm

2 pokrowce na stopy typu bucik 37,5 cm x 24 cm

1 serweta operacyjna 150 cm x 180 cm

1 serweta operacyjna wzmocniona typu pampers 175 cm x 260 cm z samoprzylepnym wycięciem "U" 20 cm x 100 cm ze zintegrowanym uchwytem do mocowania przewodów i drenów

1 serweta wzmocniona do chirurgii naczyniowo - sercowej w kształcie litery "T" 300/225 cm x 370 cm z otworem 38 cm x 40 cm wypełnionym folią operacyjną z dwoma zintegrowanymi foliowymi dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia po obu stronach otworu oraz dwiema dodatkowymi umieszczonymi w obrębie ekranu anestezyjologicznego foliowymi jednokomorowymi kieszeniami na narzędzia i 5 uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 14 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej, absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,

z zintegrowaną torbą na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie z lejkiem odprowadzającym płyny, z zintegrowanymi osłonami podpórek kończyn górnych, materiał obłożenia wykonany z dwuwarstwowego laminatu o gram. 57,5 g/m<sup>2</sup> i wytrzymałości na przenikanie cieczy min. 125 cmH<sub>2</sub>O? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 20 poz. 1:** (Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej poliuretanowej folii operacyjnej o grubości 0,048 mm paroprzepuszczalności na poziomie 750 gr/m<sup>2</sup> MVTR/ 24 h, powierzchni całkowitej 15 x 27 cm i powierzchni przylepnej 15 x 20 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 20 poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej poliuretanowej folii operacyjnej o grubości 0,048 mm paroprzepuszczalności na poziomie 750 gr/m<sup>2</sup> MVTR/ 24 h, powierzchni całkowitej 30 x 27 cm i powierzchni przylepnej 30 x 20 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 20 poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej poliuretanowej folii operacyjnej

DZPZ/333/8 UEPN/2018

o grubości 0,048 mm paroprzepuszczalności na poziomie 750 gr/m<sup>2</sup> MVTR/ 24 h, powierzchni całkowitej 45 x 57 cm i powierzchni przylepnej 45 x 50 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

**Część 20 poz. 4:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej poliuretanowej folii operacyjnej o grubości 0,048 mm paroprzepuszczalności na poziomie 750 gr/m<sup>2</sup> MVTR/ 24 h, powierzchni całkowitej 45 x 72 cm i powierzchni przylepnej 45 x 65 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 20 poz. 5:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej poliuretanowej folii operacyjnej o grubości 0,048 mm paroprzepuszczalności na poziomie 750 gr/m<sup>2</sup> MVTR/ 24 h, powierzchni całkowitej 55 x 87 cm i powierzchni przylepnej 55 x 80 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 20 poz. 6:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej poliuretanowej folii operacyjnej o grubości 0,048 mm paroprzepuszczalności na poziomie 750 gr/m<sup>2</sup> MVTR/ 24 h, powierzchni całkowitej 40 x 42 cm i powierzchni przylepnej 40 x 35 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 22 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej serwety pod pacjenta o rozmiarze 75cmx100cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa), z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjenta o szerokości min. 18 cm oraz torbą do zbiórki płynów w kształcie trójkąta ze sztywnikiem i podziałką ilościową? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 30 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepek chirurgicznego o kształcie beretu wykończonego bezlateksową gumką i wykonanego z włókniny polipropylenowej

DZPZ/333/8 UEPN/2018

o gramaturze 14 g/m<sup>2</sup> ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 30 poz.2:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepek chirurgicznego dla osób z długimi włosami, z gumką w okolicy karku, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup> ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 34 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów jednorazowego użytku wykonanych z miękkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 21 g/m<sup>2</sup>?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 39 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do operacji urologicznych T.U.R. o gramaturze 57,5 g/m<sup>2</sup>, odporności na przenikanie cieczy min. 125 cmH<sub>2</sub>O i następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 Uchwyty na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm

1 serweta do procedur TUR 210/260x225 cm

ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepłą, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny, bezlateksowa osłona na palec?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną o wymiarach 50cm x 60cm z otworem 6cm x 8cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 2 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 78cm x 145cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 3 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie zestawu do chirurgii biodra, 3 warstwowego bez dodatkowych wzmocnień, natomiast o zwiększonej gramaturze min. 75g/m<sup>2</sup>, w skład którego wchodzi :

1 serweta z wycięciem U-kształtnym 200 x 300 cm, wycięcie 10cm x 100cm

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 200cm

1 serweta 75 x 90 cm

1 serweta 150 x 200 cm

1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

2 ręczniki do rąk 30 x 40 cm

2 osłony na kończynę 35 x 120 cm

2 OP Taśma 10 x 50 cm

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 4 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie zestawu podstawowego uniwersalnego, o gramaturze min. 60g/m<sup>2</sup>, o odporności na przenikanie cieczy min. 145cm H<sub>2</sub>O oraz wytrzymałości na rozerwanie min. 80 kPa w skład którego wchodzi :

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 200cm

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm

1 serweta samoprzylepna 180 x 180cm

1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm

2 serwety samoprzylepne 75 x 100cm

2 OP taśmy 10 x 50

4 ręczniki 30 x 40

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 4 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie zestawu podstawowego uniwersalnego, o gramaturze min. 62g/m<sup>2</sup>, o odporności na przenikanie cieczy min. 185cm H<sub>2</sub>O oraz wytrzymałości na rozerwanie min. 150 kPa w skład którego wchodzi :

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 200cm;

1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;

1 serweta samoprzylepna 180 x 180cm;

1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm

2 serwety samoprzylepne 75 x 100cm;

2 włókninowe OP taśmy 10 x 50

4 ręczniki 30 x 40

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 5 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający określając kolor koszuli kolorem jasnym, dopuści koszulę w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

**Część 6 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMMS. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu w okolicach szyi, zapinanie na rzep, mankiety poliestrowe. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795. Rozmiary fartucha jednocześnie oznaczające jego długość: M, L, XL, XXL. Na opakowaniu zewnętrznym znajdują się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Zapakowanie i złożenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie, a następnie przekazanie do użytku. Gramatura min. 35g/m<sup>2</sup>, odporność na nieprzemakalność min. 30cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie min. 80kPa.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**



**Część 7 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony - jednorazowego użytku do zabiegów wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny SMMMS, sterylny, w strefie krytycznej od wewnątrz wzmocniony wstawkami z nieprzemakalnego laminatu, rękawy zakończone poliestrowym bezszwowym mankietem. Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, przy szyi zapięcie na rzep. Włóknina o gramaturze min. 75g/m<sup>2</sup> w obszarze krytycznym, poza obszarem krytycznym min 35g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym min. 305cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie dla obszaru krytycznego na sucho i mokro min. 60kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro min. 120N. Opakowanie typu papier folia, min. dwie etykiety w języku polskim zawierająca nr katalogowy, serię, datę ważności, oznaczenie producenta. Długość fartucha od najwyższego punktu ramienia: M-115cm, L-127cm, XL-135cm, XXL- 140cm. Rozmiary M,L,XL,XXL. Zgodny z normą PN EN 13795.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 8 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń sterylną, przezroczystą, jednokomorową, jednorazowego użytku w rozmiarze 30 cm x 40 cm, wykonaną z przezroczystej folii polietylenowej ( PE )?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

**Część 14 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw, który zawiera 4 ręczniki? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

**Część 25 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od złożenia próbek do Części 25 lub ich zmniejszenie do 1 sztuki.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 26 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, niepylny, wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny z marginesami z czterech stron prześcieradła?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

**Część 31 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 31 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o gramaturze 40g/m<sup>2</sup> antypoślizgowe?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

**Część 34 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny o gramaturze min. 20g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 34 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany j.m z par na op. a'100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości z 55000 par na 1100 op. a'100 szt (50 par).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe. W pozycji nr 1 części nr 34 jednostką miary jest sztuka, a nie para. Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę jednostki miary i na dokonywanie przeliczeń w powyższym zakresie..**

**Część 34 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o wymiarach : długość ok. 115cm (+/\_ 5cm) szerokość 140 cm (+/\_ 5 cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

**Część 34 poz. 1**

DZPZ/333/8 UEPN/2018

Czy Zamawiający dopuści fartuch o wymiarach : długość ok. 120cm (+/\_ 5cm) szerokość 150 cm (+/\_ 5 cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część 34 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem zakończonym gumką, zamiast elastycznego ściągacza?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część 39 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do operacji urologicznych TUR składający się z:

1 serwety na stół instrumentariuszki 150 x 190cm, chłonna na całej powierzchni, służącej jako owinięcie zestawu,

1 serwety urologicznej 200 x 240 cm zintegrowanej z nogawicami, posiadającej w części brzusznej otwór samoprzylepny w części dolnej serwety zbiornik, torba do przechwytywania płynów ze sztywnikiem, wraz z sitem i zaworem do podłączenia drenów,

2 szt. organizatorów w formie rzepu

4 chłonne ręczniki

Serweta zabiegowa wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze min 75 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie płynów min. 300 cm H<sub>2</sub>O.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Do SIWZ**

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości próbek z 2 szt. do 1 szt. z każdej pozycji.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Do SIWZ**

Prosimy Zamawiającego o informację, czy Zamawiający oczekuje złożenia próbek z dowolnego z podanych rozmiarów w Pakiecie 35 poz. 1 ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oczekuje na złożenie próbek z dowolnego rozmiaru w ilości określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do chirurgii biodra o poniższym opisie:

- wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup> wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m<sup>2</sup>. Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H<sub>2</sub>. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.

Skład :

- 1 osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm
- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U"
- 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 170x300cm
- 1 serweta o min. wym. 150x150cm
- 1 serweta o min. wym. 75x90cm
- 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm
- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 4 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę importera, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone jest dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu podstawowego o poniższym opisie: serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H<sub>2</sub>O.

Skład :

**DZPZ/333/8 UEPN/2018**

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE, wzmocniona włókniną polipropylenową
- 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x175cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm
- taśma samoprzylepna 9x50cm
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm.

Odporność na przesiąkanie płynów min. 200 cm H<sub>2</sub>O,

Siła wypychania na sucho min. 180 kPa.

Siła wypychania na mokro min. 170 kPa.

Taśma samoprzylepna na serwetach o szer. 5 cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę importerera, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Część nr 6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha o poniższym opisie:

Fartuch chirurgiczny pełnobrierowy, jałowy z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>. Szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową. Szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów wykończone elastycznym poliestrowym mankietem o dł. min 7cm. Fartuch zapinany na szyi na rzep. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne - troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora przy zakładaniu. Fartuch pakowany z dwoma ściereczkami do wycierania rąk. Fartuch i ręczniki owinięte w ochronną serwetę włókninową. Etykieta produktu w języku polskim, posiadająca dwie repositionowalne wklejki z oznaczeniem importerera, numerem katalogowym produktu, numerem lot i datą ważności (dwie etykiety z kodem kreskowym). Parametry wytrzymałości:

Odporność na rozerwanie na mokro min. 130 kPa dla pow. krytycznej

Odporność na rozerwanie na sucho min. 140 kPa dla pow. krytycznej

Odporność na penetrację płynów min. 40 cm H<sub>2</sub>O.

DZPZ/333/8 UEPN/2018

Fartuch spełniający wymogi jakościowe Normy Europejskiej EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym poziomie działania w obszarze krytycznym. Fartuchy pakowane w kopertę papierowo-foliową, a następnie w karton dodatkowo owinięty folią (opakowanie pośrednie).  
Oświadczenie informujące, że produkt jest niepalny?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Część nr 7**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania fartucha o poniższym opisie:

Wzmocniony jednorazowy jałowy fartuch operacyjny do operacji mokrych, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS, pięciowarstwowy, posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące ucisku na skórę, rękawy szerokie, zapewniające swobodę ruchów; Fartuch o gramaturze min. 35g/m<sup>2</sup> w części podstawowej. Posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia od wewnątrz fartucha z laminatu w części przedniej i  $\frac{3}{4}$  rękawach o gramaturze min. 40g/m<sup>2</sup>. Szwy fartucha wykonane metodą ultradźwiękową. Szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów wykończone elastycznym poliestrowym mankiem o dł. min 7cm. Fartuch zapinany na szyi na rzep. Fartuch wyposażony w 2 troki zewnętrzne i 2 wewnętrzne - troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Fartuch złożony w sposób zapewniający zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora przy zakładaniu. Fartuch pakowany z dwoma ściereczkami do wycierania rąk. Fartuch i ręczniki owinięte w ochronną serwetę włókninową. Etykieta produktu w języku polskim, posiadająca dwie repositionowalne wklejki z oznaczeniem importera, numerem katalogowym produktu, numerem lot i datą ważności (dwie etykiety dodatkowo z kodem kreskowym). Minimalne parametry wytrzymałości:

Odporność na rozerwanie na mokro min. 140 kPa dla pow. krytycznej

Odporność na rozerwanie na sucho min. 150 kPa dla pow. krytycznej

Odporność na penetrację płynów min. 215 cm H<sub>2</sub>O dla pow. Krytycznej

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min.105N dla pow. krytycznej

Wytrzymałość na rozciąganie na mokro min.100N dla pow. krytycznej

Fartuch spełniający wymogi jakościowe Normy Europejskiej EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym poziomie działania w obszarze krytycznym. Oferowane fartuchy muszą być pakowane w kopertę papierowo-foliową, a następnie w karton dodatkowo owinięty folią (opakowanie pośrednie). Długość fartucha rozmiar M:-120cm, L-130cm, XL-140cm, XXL-150cm wszystkie rozmiary +/-2cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 14**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania zestawu do cięcia cesarskiego o poniższym opisie:

- serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>. Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Skład :

- 1 czerwona osłona na stół Mayo o min. wym. 80x145cm

- 1 serweta główna w kształcie litery T o min. wym. 250x315cm, z przylepnym oknem wypełnionym w 100% folią chirurgiczną, otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi

- 1 serweta dla noworodka wykonana z włókniny typu Spunlace 50 g/m<sup>2</sup> o min. wym. 90x100cm

- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm,

- Siła wypychania na sucho min. 180 kPa.

- Siła wypychania na mokro min. 170 kPa

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm .

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę importera, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

**Część nr 31**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ochraniaczy z włókniny o gramaturze min.30g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część nr 34**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha jednorazowego użytku o wymiarach:

długość fartucha 120cm, szerokość 140cm - rozmiar M lub

długość fartucha 124cm, szerokość 146cm - rozmiar L lub

długość fartucha 128cm, szerokość 150cm - rozmiar XL do wyboru Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie fartucha o długości 120cm i szerokości 140cm , przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

### **Część 39**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do zabiegów urologicznych o poniższym opisie: serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>. Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Skład :

- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 185x260cm posiadająca : zintegrowane nogawice, worek do zbierania płynów z sitem i zaworkiem spustowym, przylepne okno nadłonowe oraz przylepne okno do obłożenia okolic krocza i bezlateksową osłonę na palec
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Odporność na przesiąkanie płynów min. 200 cm H<sub>2</sub>O.

Siła wypychania na sucho min. 180 kPa.

Siła wypychania na mokro min. 170 kPa.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone ma być dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 23, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści pełnobarierowe fartuchy do chemioterapii, sterylne, wykonane z włókniny TNT SMS o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>, posiadające wzmocnienia w przedniej części i na rękawach, rękawy zakończone poliestrowym mankietem, odporność na przenikanie – klasa 6 zgodnie z normą EN14126, odporność na penetrację przez zanieczyszczone aerozole – klasa 3 zgodnie z normą EN14126, spełniające normy EN 13688:2013, EN14605:2009, EN14126:2004, zarejestrowane jako środek ochrony indywidualnej, przebadany na przenikanie cytostatyków, rozmiary M i L?



**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 32, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne o ciśnieniu różnicowym 30,88 Pa/cm<sup>2</sup>, typu IIR zgodnie z normą EN 14683 spełniającej pozostałe parametry?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

**Część 32, poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne z technologią AntiFog trzywarstwową o gramaturze ok 55 g/m<sup>2</sup>, o ciśnieniu różnicowym 21 Pa/cm<sup>2</sup>, spełniającą pozostałe parametry?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Część 32, poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne o ciśnieniu różnicowym 32,78 Pa/cm<sup>2</sup>, typu IIR zgodnie z normą EN 14683 spełniającej pozostałe parametry?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

**Część 32, poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne o ciśnieniu różnicowym 32,78 Pa/cm<sup>2</sup>, typu IIR zgodnie z normą EN 14683 spełniającej pozostałe parametry?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

**Część 33, poz. 1** - Czy Zamawiający oczekuje maski będącej jednocześnie półmaską ochronną oraz maską chirurgiczną?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oczekuje maski zgodnej z opisem przedstawionym w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.**

**Część 38, poz. 1** - Czy Zamawiający dopuści półmaski ochronne niejałowe, mikrobiologicznie czyste, pakowane pojedynczo, spełniające pozostałe parametry?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Część 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul z rozcięciem do mostka, bez wiązania, wykonanych z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m kw., wymiary 120 x 140 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pytanie zostało zadane nieprecyzyjnie. Część nr 6 dotyczy fartucha, natomiast Wykonawca pyta o koszulę. Zamawiający w związku z powyższym nie może ustosunkować się do zadanego pytania.**

Część 6 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m kw.?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pytanie zostało zadane nieprecyzyjnie. W części nr 6 nie ma pozycji nr 2. Zamawiający w związku z powyższym nie może ustosunkować się do zadanego pytania.**

Część 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy o gramaturze 40 g/m kw ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.**

Część 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań wykonanych z nieprzezroczystej, miękkiej i układalnej włókniny typu SMS o gramaturze 40 g/m kw.?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

.....  
podpis osoby uprawnionej